CAS DE COMPTOIR
‘DÉPISTAGE ET AUTOTESTS VIH À L’OFFICINE’

Prise de risque sexuel <48h
Prise de risque sexuel il a 8 jours
Demande d’autotest VIH hors prise de risque
Demande d’autotest VIH sans discussion possible
Conseil post-test ayant donné un résultat positif
Demande d’autotest par une jeune fille
Rupture de préservatif

Elaboré et validé par le groupe
Médicament / Pharmaciens SFLS



Version actualisée le 30 juin 2015

PRISE DE RISQUE SEXUEL <48H

Demande d'autotests

Un homme , la quarantaine, se présente au comptoir…

« Je voudrais savoir si vous vendez des auto-tests et à quel prix ? »



- Comment menez-vous cet entretien ?

Demande d'autotests

Un homme, la quarantaine, se présente au comptoir…



→ Proposer au patient d'aller discuter à l'écart dans un espace de **confidentialité**

→ « Pouvez-vous me dire quelles sont les raisons vous amenant à vouloir faire ce test ? »

- Prise de risque ?
- Symptômes ?

« Après une soirée un peu arrosée, j'ai eu un problème de préservatif avec ma partenaire, une personne que j'avais rencontrée au cours de la soirée. Je n'ai aucun moyen de la retrouver : je ne sais même plus trop quel est son prénom…»

Comment réagissez-vous ?

Un homme, la quarantaine, se présente au comptoir…



→ Connaître la chronologie

« A quand remonte cette prise de risque ? »

Scénario 1:

« *Cette nuit…* »

Comment réagissez-vous ?

Vite !!!!!!

Traitement post-exposition à envisager



- Orienter cette personne vers les **Urgences***
  - Si possible, avec son/sa partenaire

*Coordonnées sur fiche contacts

- **Traitement post-exposition (TPE)**
  - Objectif : réduire le risque de contamination
  - Plus le délai entre l'exposition et la prise augmente, plus le risque augmente (idéalement prise moins de 4h après exposition)
  - Délai de prise admis en France : dans les 48 heures
  - Disponible dans les établissements de santé (Pharmacie hospitalière, urgences)
    - Exemples de traitement :
      - Kaletra® (2 cp x 2, (/12h)) + Truvada® (1 cp / 24h) ; repas ++ ;
      - Prezista®800mg (1cp /24h) +Norvir® (1cp/24h)+ Truvada® (1 cp / 24h) ; repas ++ ;
      - Stribild (1 cp / 24h); repas ++.
  - Ré-évaluation par un infectiologue (hôpital ou CDAG/CIDDIST/CeGIDD):

    reconduite qsp 28 jours ou arrêt
    - EI digestifs, fatigue +++
    - Suivi : 3 mois après la fin du TPE

PRISE DE RISQUE SEXUEL IL A 8 JOURS

Un homme, la quarantaine, se présente au comptoir…



A quand remonte la prise de risque ?

Scénario 2:

« Il y a 8 jours, c'est pour ça que je voudrais savoir. Je m'inquiète! »

Comment réagissez-vous ?

Un homme, la quarantaine, se présente au comptoir…



TPE non adapté car > 48 heures

Résultat de l'autotest (AT) : totalement fiable si 3 mois sans prise de risque.

Par rapport à cette prise de risque de 8 jours, il est préférable d'orienter ce patient car l'autotest ne donnera pas un résultat fiable.

→ Orientation vers

- **CDAG/CIDDIST/CeGIDD**

(avoir une liste de ces centres à portée de main)





- **Médecin traitant**

Si le patient a déjà pris ce type de risque dans le passé et n'a pas fait de dépistage récemment, vous pouvez lui proposer l'autotest en lui expliquant bien que sera utile pour vérifier sa situation par rapport aux risques pris il y a plus de 3 mois.

DEMANDE D'AUTOTEST HORS PRISE DE RISQUE

Un homme, la quarantaine, se présente au comptoir…

« Je voudrais savoir si vous vendez des auto-tests et à quel prix ? »



Comment menez-vous cet entretien ?

Un homme, la quarantaine, se présente au comptoir…



→Proposer au patient d'aller discuter à l'écart dans un espace de **confidentialité**

→ L'interroger sur raisons/chronologie ?

« Je voudrais faire le point sur le VIH et je n'ai pas envie de demander à mon médecin. Vous comprenez, je le connais et je ne voudrais pas qu'il s'imagine je ne sais pas quoi ! »

Comment réagissez-vous ?

→ Questionner sur la prise de risques, la chronologie, la présence de symptômes.

→ Présenter le principe de l'autotest : comment ça marche ?

- Quand notre corps est exposé à des micro-organismes (virus, bactéries), il réagit en fabriquant **des substances appelées anticorps** qui vont participer à leur neutralisation
- Mais, cette fabrication demande un certain temps,
- Or, les autotests dépistent les anticorps
- Donc, pour que l'autotest montre un résultat positif, il faut que la dernière prise de risque remonte au moins à **3 mois**.


→ Présenter l'autotest (notice)



NOTICE D'UTILISATION

- autotest VIH® est un autotest de dépistage du VIH (Virus responsable du SIDA) sur un prélèvement de sang obtenu au bout du doigt.
- Cet autotest est fiable pour détecter une infection au VIH datant de plus de 3 mois.
- autotest VIH® est un dispositif de diagnostic in vitro à usage unique.
- autotest VIH® est destiné à un usage par des profanes dans un cadre privé.
- Le temps nécessaire pour réaliser l'autotest est d'environ 5 minutes et le temps d'attente avant la lecture est de 15 minutes.
- Assurez-vous de disposer d'un minuteur.
- Lisez attentivement et complètement la notice d'utilisation avant de commencer le test.


CONTENU DU KIT

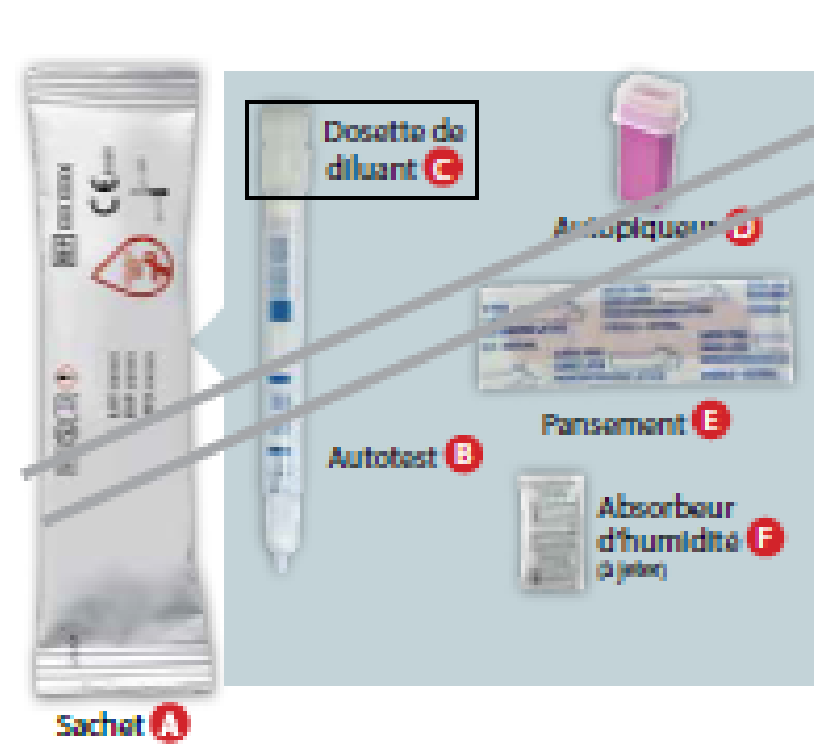


Support G



Lingette désinfectante H



Compresse I

ÉTAPE 1

1. Positionnez le support G sur une surface plane sans vibrations.
2. Retirez la dosette de diluant C située sur la partie haute de l'autotest B.




3. Introduisez-la avec votre doigt au fond du support G.

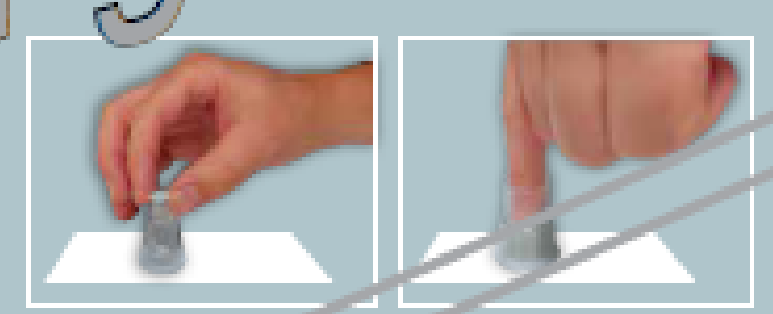

ÉTAPE 2 (LES ÉTAPES 2 ET 3 DOIVENT SE FAIRE DE FAÇON CONTINUE)

1. Lavez-vous les mains de préférence à l'eau chaude et séchez-les.
2. Ouvrez les sachets contenant la lingette désinfectante H et la compresse I.
3. Nettoyez le bout du doigt avec la lingette désinfectante H et attendez que votre doigt sèche.
4. Prenez l'autopiqueur D et enlevez son capuchon transparent. Appliquez sa face rouge sur votre doigt et appuyez fortement jusqu'à sentir la pénétration de l'aiguille.

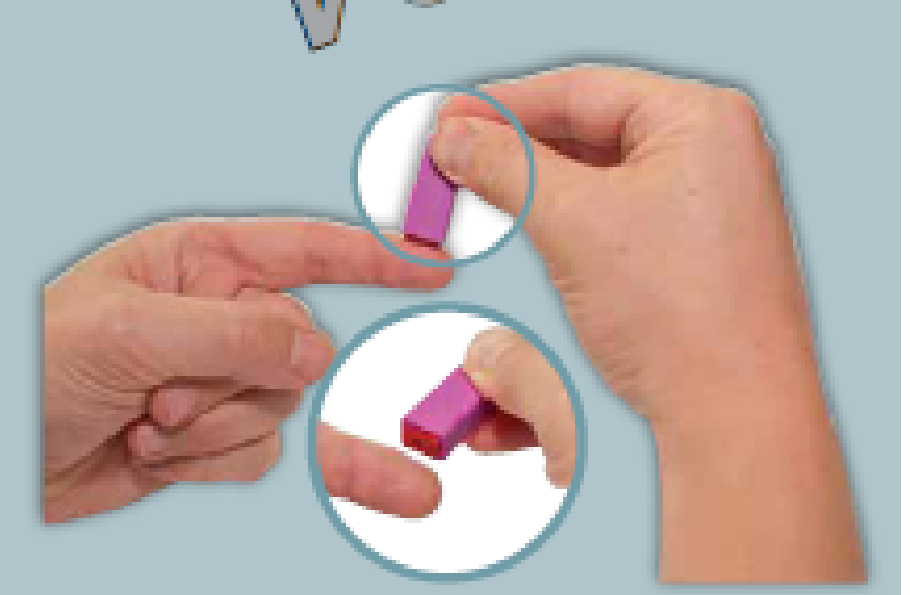

ÉTAPE 2 (SUITE)

5. Pressez délicatement le bout de votre doigt pour former une première grosse goutte de sang. Essuyez-la à l'aide de la compresse I.




6. Pressez à nouveau délicatement, sans trop appuyer, le bout du doigt pour former une nouvelle grosse goutte de sang.
7. Mettez l'autotest B pointe vers le bas en contact avec la goutte de sang comme indiqué ci-dessous (angle de 90°) jusqu'à ce que la pointe de l'autotest soit remplie de sang.

volume de sang à prélever


ÉTAPE 3

1. Munissez-vous à nouveau du support G contenant la dosette de diluant C. Positionnez-le sur une surface plane sans vibrations.



2. Prenez votre autotest B en main pointe vers le bas. Introduisez-le fortement dans le support G afin de percer la dosette de diluant C.

ENFONCEZ TRÈS FORT
VOUS CONSTATEZ 3 CRANS DE RÉSISTANCE

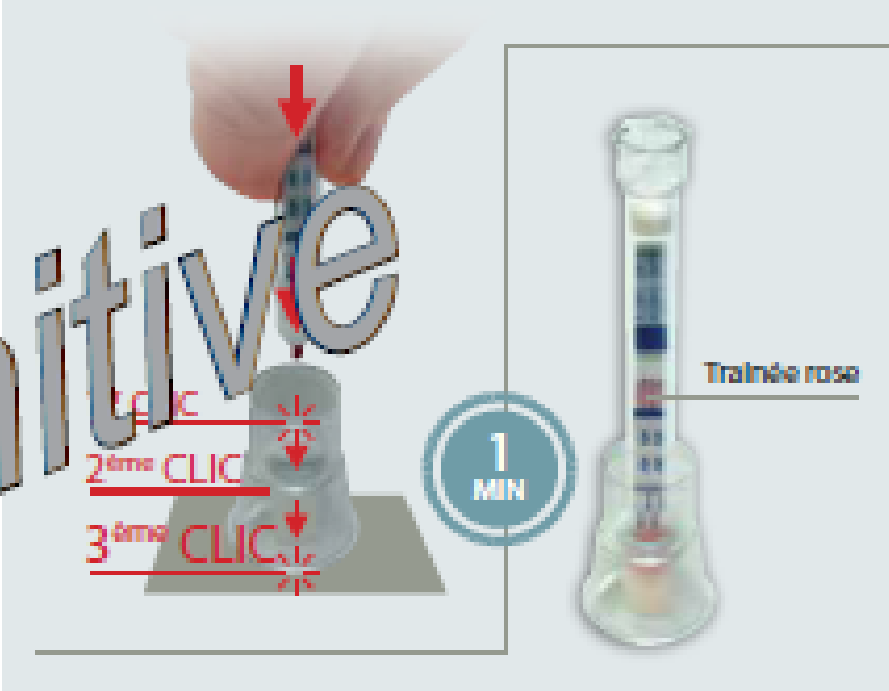

3. Observez l'apparition d'une traînée rose moins d'une minute après l'enfoncement.
4. Appliquez le pansement E sur votre doigt.

LE TEST EST EN COURS

⚠ Si la traînée rose n'apparaît pas dans la minute, ré-enfoncez fort pour introduire complètement l'autotest B.

L'autotest doit être maintenu vertical jusqu'à la fin de l'étape 4.

ÉTAPE 4

1. Notez l'heure et attendez 15 minutes avant de lire le résultat.



Ne lisez pas au-delà de 20 min

AAZ.AK09-E (20150414) Notice d'utilisation autotest VIH®
Cette notice d'utilisation est disponible en plusieurs langues sur www.autotest-sante.com

ÉTAPE 5 : LECTURE DU RÉSULTAT DE L'AUTOTEST

AUTOTEST NÉGATIF

Si votre autotest correspond au cas présenté ci-dessous, votre résultat est négatif.

1 bande présente : la bande contrôle.

La bande peut être claire ou foncée.

CONTRÔLE

PLACEZ VOTRE AUTOTEST

VOTRE AUTOTEST EST NÉGATIF

VOUS ÊTES PROBABLEMENT SÉRONÉGATIF

autotest VIH® est un test fiable, toutefois :

Dans le cas d'un résultat négatif, il est important de s'assurer que vous n'êtes pas dans la fenêtre sérologique (en séroconversion*) et de consulter un médecin.

Si dans les 3 derniers mois, vous identifiez une possibilité de contamination au VIH, vous ne pouvez affirmer que vous êtes séronégatif à ce jour. Vous devez refaire l'autotest 3 mois après votre dernier risque d'exposition au VIH.

* La séroconversion désigne la période nécessaire à l'apparition des anticorps en quantité suffisante afin qu'on puisse les détecter.

AUTOTEST POSITIF

Si votre autotest correspond à l'un des cas présentés ci-dessous, votre résultat est positif.

2 bandes présentes : la bande contrôle et la bande test.

L'une des 2 bandes peut être plus claire ou plus foncée que l'autre.

CONTRÔLE

TEST

VOTRE AUTOTEST EST POSITIF

VOUS ÊTES PROBABLEMENT SÉROPOSITIF

1. CONSULTEZ UN MÉDECIN dès que possible et expliquez-lui que vous avez obtenu un résultat d'autotest VIH positif.
2. VOUS DEVEZ RÉALISER UN TEST DE CONFIRMATION EN LABORATOIRE POUR VÉRIFIER VOTRE RÉSULTAT D'AUTOTEST.
3. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES.

Jusqu'au résultat de votre test de confirmation, évitez toute activité qui pourrait transmettre le VIH à d'autres personnes.

Si votre autotest ne correspond à aucun des cas présentés ici, le résultat est indéterminé (aucune bande ou 1 seule bande : bande test), votre test n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez rien conclure. Vous devez refaire un autre test. En cas d'autotests indéterminés répétés, veuillez consulter votre médecin.

Les autopiqueurs usagés peuvent être considérés par vos autorités locales comme des déchets médicaux. Afin de réduire le risque de blessure avec les dispositifs usagés, respectez les recommandations locales pour leur élimination. Adressez-vous à votre pharmacien. Plus d'informations sur www.autotest-sante.com

> Besoin de soutien et d'orientation ?
> Besoin d'aide pour réaliser ou interpréter votre autotest ?
> Des questions liées au VIH ou aux autres infections dites sexuellement transmissibles ?



7j/7 24h/24 GRATUIT CONFIDENTIEL ANONYME

PRINCIPE ET PERFORMANCES

autotest VIH® est un test immunochromatographique consistant à détecter dans le sang humain les anticorps produits après une infection par le virus du VIH.

L'apparition de la bande contrôle permet de vérifier le bon fonctionnement du test.

Sensibilité* : la sensibilité de cet autotest a été évaluée à 100 % avec un intervalle de confiance s'étendant de 99,1 % à 100 %. Toutes les personnes séropositives de l'étude ont été correctement détectées. Il n'y a pas eu de faux négatifs** recensés.

Spécificité* : la spécificité de cet autotest a été évaluée à 99,8 % avec un intervalle de confiance s'étendant de 99,5 % à 100 %. 0,2 % des personnes séronégatives ont été incorrectement détectées, soit 0.2% de faux positifs***.

Fiabilité : l'étude de praticabilité de cet autotest par des personnes profanes a montré que plus de [illegible] des participants ayant manipulé cet autotest obtiennent un résultat interprétable et plus de 98,1 % des autotests sont interprétés correctement. Les autotests positifs sont interprétés correctement dans 100 % des cas.

Interférence : l'examen d'échantillons contenant des substances ou présentant [illegible] d'altérer les résultats de ce test n'a mis en évidence aucune interférence notable.

Le détail des études ayant conduit aux résultats mentionnés [illegible] demande sur www.autotest-sante.com

* Études réalisées sur 503 personnes (sensibilité) et 205[illegible] aux Etats-Unis et de l'Union Européenne.
** Faux négatif : un échantillon connu positif [illegible] de façon erronée par le dispositif.
*** Faux positif : un échantillon connu négatif [illegible] positivement de façon erronée par le dispositif.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE

- L'autotest est uniquement destiné à l'autodiagnostic du VIH pour un usage privé. Il ne peut en aucun cas être utilisé pour un autre diagnostic ou un autre usage.
- L'autotest ne doit être utilisé qu'avec du sang capillaire fraîchement prélevé selon la technique indiquée et ne doit pas être utilisé sur du sérum ou du plasma.
- Conservez l'autotest dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec entre 8° C et 30° C à l'abri des rayons du soleil.
- L'autotest est à usage unique, ne le réutiliser en aucun cas.
- N'ouvrez l'emballage qu'au moment où vous êtes prêt à effectuer le test.
- L'autotest n'est pas destiné au suivi thérapeutique de patients recevant une thérapie antirétrovirale.
- L'utilisateur de l'autotest ne doit pas prendre de décision médicale sans consulter d'abord son médecin, que le résultat soit positif ou négatif.
- Il peut exister des résultats faux positifs (0.2% selon l'étude spécificité) ou faux négatifs dans les cas suivants : exposition supposée au VIH dans les 3 mois précédents la réalisation du test (fenêtre sérologique), dans les situations d'immunodépression profonde ou d'infection par un variant rare et pour les personnes séropositives sous traitement antirétroviral.
- Une conservation en dehors des conditions indiquées ou le non-respect des limites d'utilisation peuvent entraîner des résultats erronés.
- Ne pas utiliser l'autotest si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Ne pas utiliser l'autotest après la date de péremption.
- Si la notice ou les instructions d'utilisation ne vous paraissent pas claires, contactez immédiatement Sida Info Service au 0 800 840 800 (24h/24 et 7j/7).
- Conservez l'autotest et ses accessoires hors de portée des enfants, les composants inclus dans le test peuvent présenter un danger en cas d'ingestion et peuvent provoquer des irritations.
- autotest VIH® est un moyen complémentaire de dépistage du VIH parmi d'autres possibilités existantes. autotest VIH ne dépiste que l'infection à VIH et pas les autres maladies sexuellement transmissibles.
- AAZ-LMB décline toute responsabilité liée à l'utilisation, la distribution ou la dispensation de l'autotest VIH® ou de ses éléments en dehors des indications et limites d'utilisation mentionnées dans la notice d'utilisation en vigueur.

Des informations complémentaires et une vidéo de démonstration sont disponibles sur www.autotest-sante.com

Fabriqué par AAZ-LMB Sogaris 217 - 94664 Rungis Cedex - France







Légende des symboles :



: lire attentivement la notice d'utilisation : ne pas réutiliser IVD : dispositif médical de diagnostic in vitro : date de péremption

CE : marquage CE : à conserver entre +8 et +30°C




Attention : [illegible]



Sous licence Chembio. Notice d'utilisation autotest VIH® - AAZ.AK09-6 (20150414) – Cette notice d'utilisation est disponible en plusieurs langues sur www.autotest-sante.com

« Et si c'est positif, c'est que j'ai le Sida ? »

Que pouvez-vous répondre ?

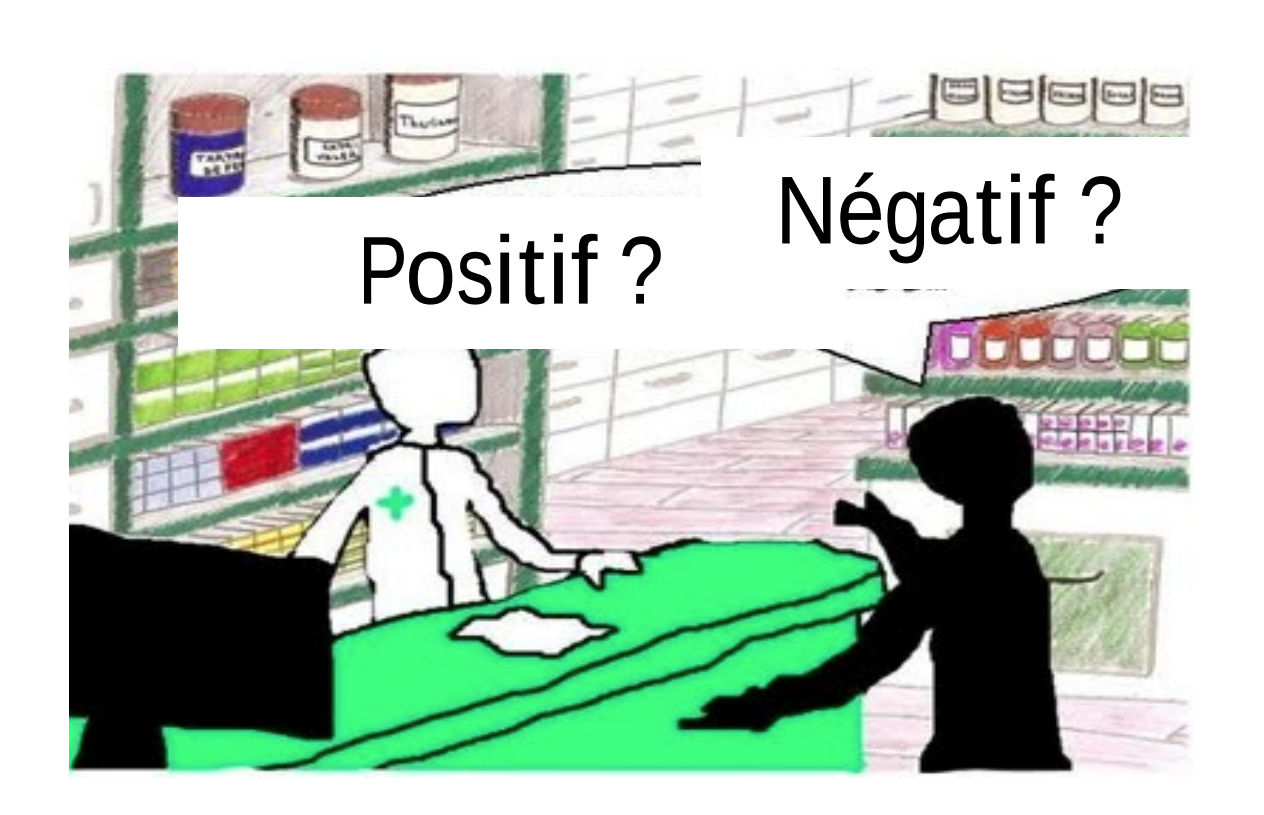

Test positif

→ Soit des anticorps anti-VIH rendent l'auto-test positif, il faut faire un contrôle sanguin pour confirmer ou infirmer une séropositivité VIH


Où ?

- CDAG/CIDDIST (futur CeGIDD)
- Médecin traitant

→ Soit c'est un faux positif (situation très rare)

- Il faut alors faire un test sanguin ELISA de 4 ° génération en laboratoire ou en CDAG/CIDDIST (futur CeGIDD)

« Et si c'est négatif : c'est sûr que je n'ai pas le VIH ? »

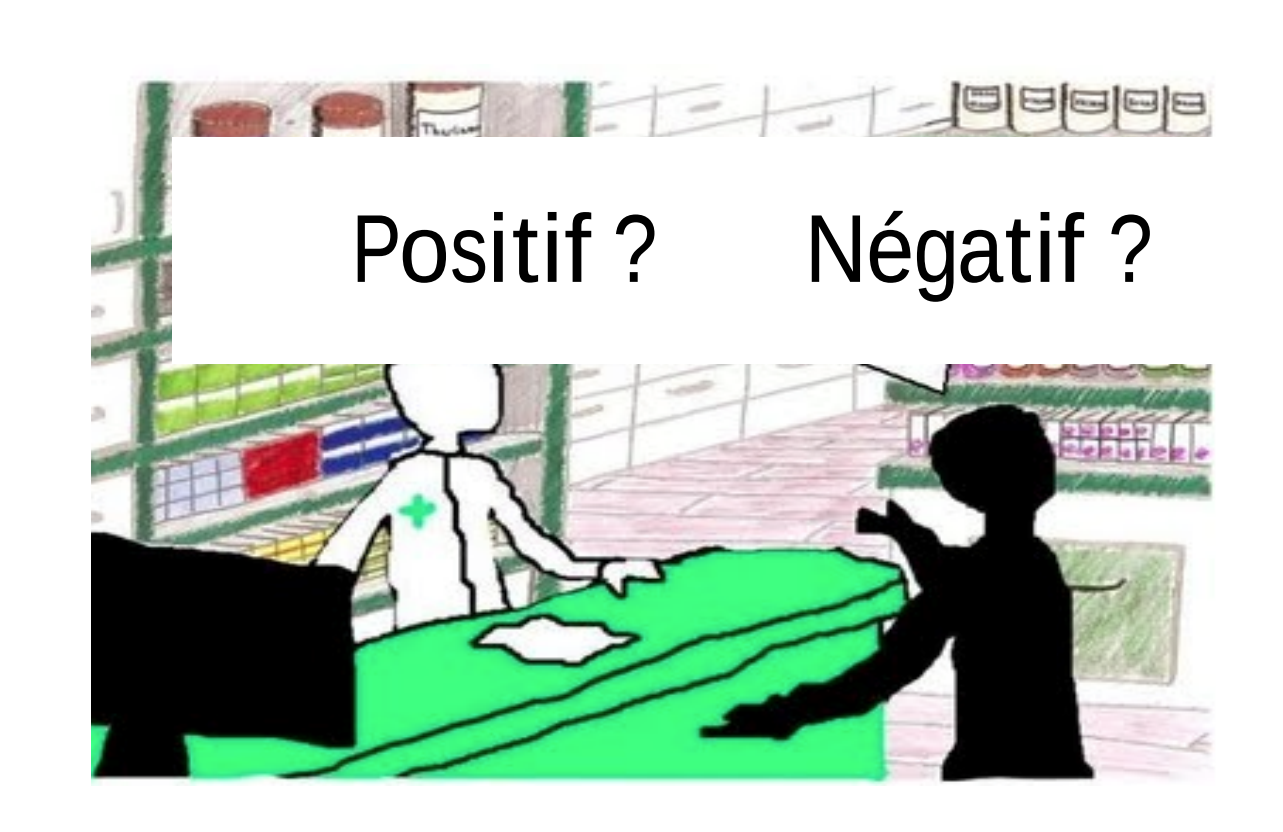

Que pouvez-vous répondre ?

Test négatif

→ Il n'y a donc pas d'anticorps anti-VIH détectés par l'AT
- Soit parce qu'il n'y a pas de virus VIH effectivement
- Soit parce que les anticorps ne sont pas encore fabriqués en cas d'exposition depuis moins de 3 mois; si c'est le cas, il faut contrôler avec un test dans un CDAG ou un laboratoire de ville (prise de sang pour faire un test ELISA de 4° génération)

→ Information : TPE et prévention (autres IST !!! Elles peuvent toutes être dépistées et guéries sauf VIH) + Vaccination hépatite B !



« J'ai entendu dire qu'il existait le VIH 1 et 2
Est-ce que votre test peut détecter les 2 ? »

Que pouvez-vous répondre ?

→Les autotests dépistent le VIH1 et le VIH2, mais ne les différencient pas.

« Est-ce que je peux obtenir un remboursement de la sécurité sociale ? »

→ NON, pas actuellement

- Remboursement 100% des tests de laboratoire si ordonnance
- Gratuit : CDAG/CIDDIST (futur CeGIDD), TROD en milieu associatif

« Et comment je peux être sûr que j'ai bien réalisé mon test ? »

→ Il y a 2 fenêtres dans le test.

- Si un trait apparaît dans la fenêtre « témoin », vous avez correctement réalisé la manipulation (ne pas hésiter à sortir la notice de la boite et à montrer la photo au patient).



« Si je prends des médicaments, ça interagit avec le résultat de mon test ? »

→ NON, pas de réaction croisée

- Sauf parfois pour des patients séropositifs traités par des antirétroviraux depuis longtemps (pour ces patients l'autotest peut être négatif, exceptionnel, mais le test ELISA sera positif).

Vous annoncez le prix de vente du test : 25 euros (prix estimé)

« C'est un coût !! Je peux ré-utiliser plusieurs fois le même test ? »

→ NON il n'en n'est pas question.

« Comment éliminer le test utilisé ? »

→ Le mettre dans le sachet prévu et l'apporter dans un lieu de collecte DASTRI (pharmacie); il ne doit pas être mis à la poubelle.

DEMANDE D'AUTOTEST SANS DISCUSSION POSSIBLE

Un homme, la quarantaine, se présente au comptoir…

« Je voudrais un auto test VIH s'il vous plait »

(patient pressé et/ou nombreux patients attendant derrière et/ou pas d'espace confidentiel…)



Comment menez-vous cet entretien ?

Un homme, la quarantaine, se présente au comptoir…



→Proposer au patient d'aller discuter à l'écart dans un espace de **confidentialité**

→ L'interroger sur raisons/chronologie ?

« Je ne souhaite pas en discuter. Je suis pressé. Je veux juste payer mon test s'il vous plait. »

Comment réagissez-vous ?

→Option 1 (si confidentialité possible): transmettre à l'oral au patient les points essentiels pour une utilisation correcte de l'autotest

1. lisez attentivement la notice avant de faire le test.
1. préparez bien le support avec le diluant avec de commencer le test.
2. vos mains et votre doigt doivent être propres et secs. Le test est réalisé sur la deuxième goutte de sang exprimée. La compresse sert à essuyer la première goutte.
3. il faut appuyer fort pour introduire le test dans son support. Une trainée rose apparaissant très rapidement vous indiquera que c'est correctement introduit. Sinon ré appuyez.
4. il faut lire les résultats au bout de 15 minutes, sans attendre au-delà de 20 minutes.
5. Lecture des résultats:
   - si une seule bande apparait le résultat est négatif → vous êtes séronégatif si vous n'avez pris aucun risque depuis au moins 3 mois.
   - si deux bandes apparaissent → vous êtes probablement séropositif: le résultat de cet autotest doit être confirmé par un test plus fiable réalisé en laboratoire. Consultez un médecin dès que possible (en ville ou dans un CDAG ou à l'hôpital) et expliquez lui que vous venez d'obtenir un résultat d'autotest VIH positif, il vous accompagnera dans la vérification de ce résultat et pour un suivi médical ensuite si nécessaire.

→Option 2 = information minimum à donner à tout patient achetant un autotest VIH: remettre au patient une petite fiche (en plus du kit autotest) sur laquelle sont notés ces points essentiels.

→Dans les deux cas: remettre au patient une petite carte sur laquelle sont noté le n° Sida Info Service + numéro de votre pharmacie + adresse et numéro du CDAG le plus proche et du service d'urgences le plus proche. La préparation de cette fiche en amont est très utile (a photocopier et à conserver dans un endroit facile d'accès pour toute l'équipe).

Option 2 = exemple de 'fiche mémo' *(à chaque équipe de personnaliser sa fiche mémo avec les points essentiels et surtout le contact de la pharmacie en cas de questions).*

- **Points essentiels pour une utilisation correcte de l'autotest**
- Lire attentivement la notice avant de faire le test.
- Préparer bien le support avec le diluant avec de commencer le test.
- Vos mains et votre doigt doivent être propres et secs. Le test est réalisé sur la deuxième goutte de sang exprimée. La compresse sert à essuyer la première goutte.
- Appuyer fort pour introduire le test dans son support. Une trainée rose apparaissant très rapidement vous indiquera que c'est correctement introduit. Sinon ré-appuyez.
- Lire les résultats au bout de 15 minutes, sans attendre au-delà de 20 minutes.

- **Lecture des résultats**
- Si une seule bande apparait : le résultat est négatif
- → Vous n'êtes pas infecté si vous n'avez pris aucun risque depuis au moins 3 mois.
- Si deux bandes apparaissent le résultat est positif
- → Vous êtes probablement séropositif: Ce résultat doit être confirmé par un test plus fiable réalisé en laboratoire. Consultez un médecin dès que possible (en ville ou dans un CDAG ou à l'hôpital) et expliquez-lui que vous venez d'obtenir un résultat d'autotest positif, il vous accompagnera dans la vérification de ce résultat et pour un suivi médical ensuite si nécessaire.

- TAMPON DE L'OFFICINE

CONSEIL POST-TEST RÉSULTAT POSITIF

Demande d'autotest

Un homme que vous aviez conseillé pour l'achat d'un autotest, revient à l'officine…

Il semble très abattu et vous dit qu'après un résultat positif de l'autotest, il a pris contact avec son médecin traitant pour réaliser des examens en laboratoire.

Le diagnostic a été posé : il est séropositif.

Il vous dit qu'il est abasourdi par la nouvelle. Son médecin traitant a contacté le service de Maladies Infectieuses du CHU : il a un RDV mais il ne sait pas s'il s'y présentera.

« *Finalement, à quoi bon maintenant, ils ne vont pas me guérir!* »

Que pouvez-vous lui dire ?



Demande d'Autotest

Un homme que vous aviez conseillé pour l'achat d'un autotest, revient à l'officine…

Cet homme est en phase de choc

→ Proposer au patient d'aller discuter à l'écart dans un espace de **confidentialité**

→ Lui demander

- s'il y a quelqu'un qui puisse être près de lui tous ces jours à venir, et l'accompagner chez le médecin ; l'assurer de notre disponibilité
- ce que signifie le VIH pour lui.

Etant peu perméable aux informations à ce stade, être bref et simple, par exemple : avec des traitements, on peut vivre, travailler, avoir des enfants, une famille et accomplir ses projets.



DEMANDE D'AUTOTEST PAR UNE JEUNE FILLE

Demande d'autotests

Une jeune fille se présente au comptoir…

Elle vous demande un autotest VIH car elle a vu de la publicité sur Internet.

Au cours de vos échanges, elle vous dit avoir 14 ans.

Peut-on proposer un autotest à cette personne ?



Demande d'autotests

Une jeune fille se présente au comptoir…

→Les autotests peuvent être dispensés aux mineurs, sans accord parental ; il faut adapter les explications à la maturité de la personne.

→Proposer au patient d'aller discuter à l'écart dans un espace de **confidentialité**

→Orienter vers

- Centre de planification familiale
- Médecin traitant
- CIDDIST/CDAG (futur CeGIDD)

Utile d'avoir une liste de ces différentes structures à portée de main.



Exemple de 'fiche contacts' à compléter par chaque pharmacien

Réseau d'accompagnement dépistage / prise en charge VIH		
Structure	**Coordonnées**	**Jours et heures d'ouverture**
CDAG Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (deviendront des CeGIDD à partir de 2016)		
CIDDIST Centre d'Information, de Diagnostic et de Dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (deviendront des CeGIDD à partir de 2016)		
Centre de planning familial le plus proche		
Laboratoire de biologie médicale		
Médecin(s) généraliste(s)		
Médecin(s) infectiologue(s) en ville		
Service hospitalier proposant consultations VIH		
URGENCES les plus proches proposant un traitement post-exposition au VIH		
Pharmacie hospitalière proposant des traitements ARV (et TPE)		
Réseau ville-hôpital VIH		
COREVIH (Comité de Coordination de la lutte contre l'infection par le VIH)		
Association(s) de soutien aux personnes séropositives		
CAARUD le plus proche		
Centre d'hébergement d'urgence le plus proche		

RUPTURE DE PRÉSERVATIF

Exposition sexuelle (VIH, IST, grossesse)

- **L'accident de préservatif (homme)**
  - Un jeune homme demande la « pilule du surlendemain » (EllaOne®) pour sa partenaire, après un accident de préservatif, quelques heures après une soirée festive.

« Je pense qu'il y a un problème de taille :


les préservatifs ne sont jamais assez grands ! »

Exposition sexuelle (VIH, IST, grossesse)
Un homme / une femme souhaite des conseils concernant les préservatifs…

→Proposer au patient d'aller discuter à l'écart dans un espace de **confidentialité**

→ Faire le point

- Produit utilisé en lui-même : un autre plus adapté ?
- Cette situation a-t-elle conduit à une prise de risque ?
  - Si oui, chronologie ?
  - Si plus de 48h → Dépistage : VIH MAIS AUTRES IST AUSSI !!
  - Situation où TPE peut être proposé (<48h) ou présenté

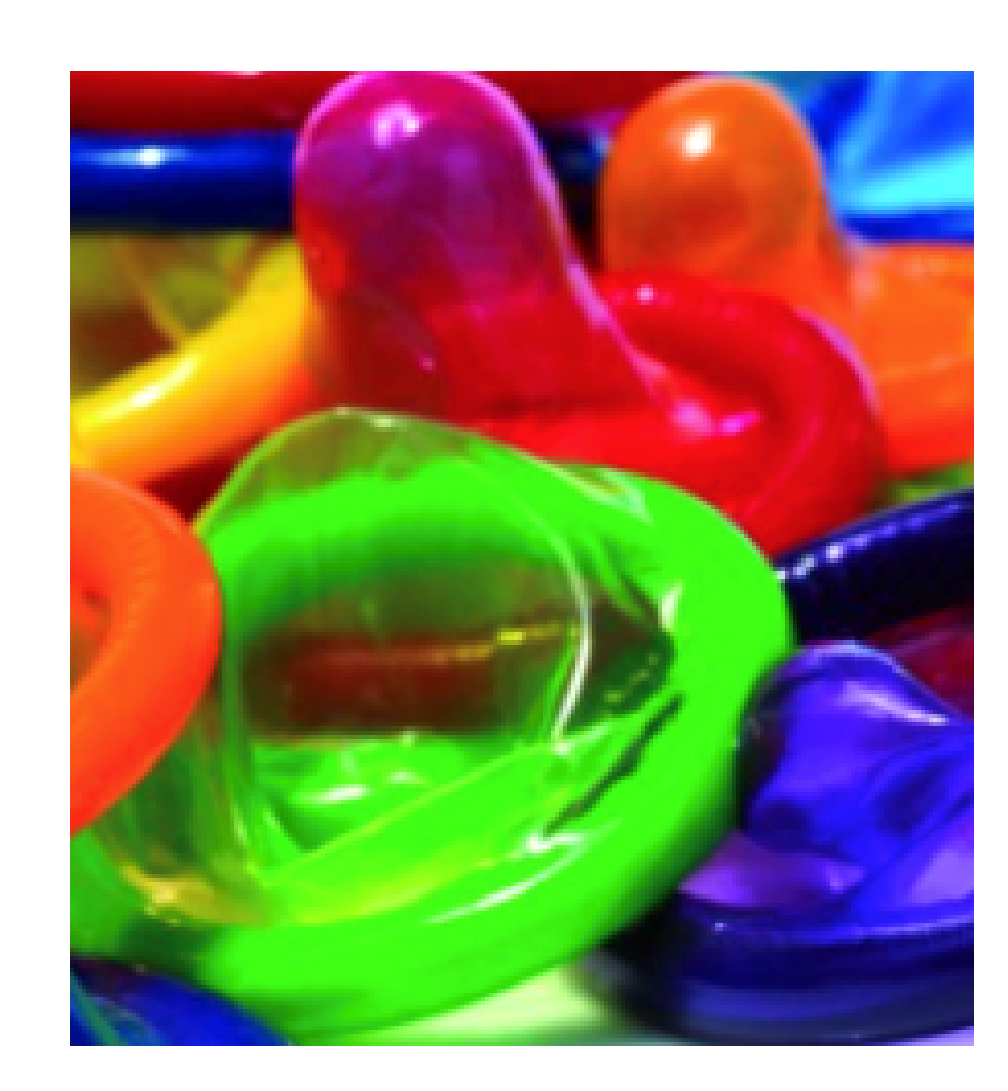

Exposition sexuelle (VIH, IST, grossesse)

Un homme / une femme souhaite des conseils concernant les préservatifs…

Au cours de l'entretien, il vous dit être allergique au latex et mal à l'aise avec l'utilisation du préservatif masculin qui coupe un peu la relation sexuelle.

Que pouvez-vous lui conseiller?



Exposition sexuelle (VIH, IST, grossesse)
Un homme / une femme souhaite des conseils concernant les préservatifs…

→ Préservatif féminin, une **alternative** pour la prévention

- Moins connus par le public
- En polyuréthane, en nitrile : pas de problème d'allergie au latex
- Utilisation de lubrifiants possible
- Mise en place : possible avant les rapports
- Retrait : possible à distance de la fin des rapports
- Remettre mode d'emploi préservatif féminin (cf. doc INPES)

« Faut-il mettre un préservatif masculin et un féminin ? »

→ NON

« Vous me dites qu'il faut guider le sexe lors de la pénétration, ma partenaire devra tenir le préservatif pendant toute la durée du rapport ? »

→ NON

Les IST

- Symptômes variables
  - brûlures, écoulements au niveau organes sexuels etc.
  - pas de signes
  - Parfois complications à type de stérilité, cancer col utérus
- Site internet : info-ist.fr
  - Blénnorragie gonococcique
  - Hépatite B : Vaccin !
  - Herpès génital
  - Chlamydiose
  - Mycoplasme/Trichomonase
  - Papillomavirus : vaccin
  - Syphilis
  - VIH

Auteurs

- Philippe ARSAC (Médecin, institut Fournier Paris)
- Emmanuelle BOSCHETTI (Pharmacien, CHU Nancy)
- Laurence BOYER (Médecin, CHU Nancy)
- Agnès CERTAIN (Pharmacien ,CHU Bichat)
- Christine JACOMET (Médecin, CHU Clermont-Ferrand)
- Julie LANGLOIS (Pharmacien consultante, Paris)
- Bruno LAURANDIN (Pharmacien officinal, Suresnes)
- Sylvia PUGLIESE-WEHRLEN (Pharmacien, CHU Nice)
- Hervé TROUT (Pharmacien, CHU Lariboisière)

Remerciements

- **Groupe Médicament-Pharmaciens SFLS** :
  http://www.sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments
  - Présidents : Eric BILLAUD et Agnès CERTAIN,
  - Secrétaire : Julie LANGLOIS,
  - Et Philippe ARSAC, Emmanuelle BOSCHETTI, Pierre BOUTTAZ, Laurence BOYER, Christine JACOMET, Bruno LAURANDIN, Sylvia PUGLIESE, Hervé TROUT, David ZUCMAN.

- **COREVIH Bretagne**
- **Ordre des Pharmaciens / Cespharm**
- **Haute Autorité de Santé**
- **Direction Générale de la Santé**